Beta Analytic, LLC
4985 SW 74th Court
Miami, FL 33155 USA
Tel: (305) 667-5167
liliana.durham@sgs.com

ISO/IEC 17025:2017-Accredited Testing Laboratory

BetaCal 5.0

Calibrazione dell'età radiocarbonica in anni di calendario

(Metodo High Probability Density Range: MARINE20)

(Variabili: d13C = -2.37 o/oo : DeltaR = 0 +/- 0)

Beta-Codice del laboratorio **853115**

Età radiocarbonica convenzionale (BP) **780 +/- 30 BP**

780 +/- 30 BP Corretto per effetto serbatoio locale

Intervalli calibrati di probabilità del 95,4%

(95.4%) 1544 - 1873 cal AD (406 - 77 cal BP)

Intervalli calibrati di probabilità del 68,2%

(68.2%) 1645 - 1802 cal AD (305 - 148 cal BP)

Ostrica

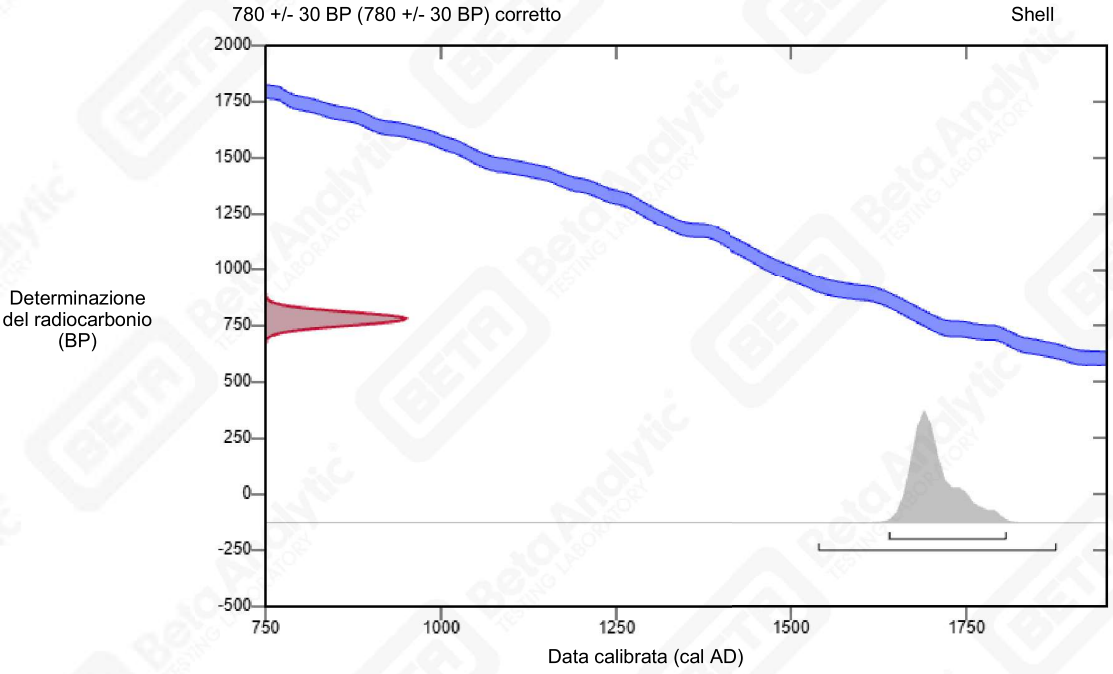

Database utilizzato

MARINE20

Riferimenti

Riferimenti al metodo della probabilità

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

Riferimenti al database MARINE20

Heaton, et al., 2020, Radiocarbon 62(4): 779-820.